

	Ветеринарски специјалистички институт ``Краљево`` Жичка 34, 36 000 Краљево; Република Србија	
	Veterinary specialized institute ``Kraljevo`` Zicka 34, 36 000 Kraljevo; Republic of Serbia	
Tel: +381(0)36-361-361 Fax: +381(0)36-360-011 www.vsikv.com e-mail: vetiskv@tron-inter.net		

Broj registra:	5-136-00	Privredni sud Kraljevo
Broj računa:	325-9500600046513-94	Vojvodanska banka
P.I.B.	100240259	Matični broj: 07333552

Pravila odlučivana i izjava o usaglašenosti

Izvod iz SOP 17.01 za izradu izveštaja o ispitivanju

Ovim dokumentom se opisuje način na koji Laboratorija VSI Kraljevo daje izjavu o usaglašenosti koja je sastavni deo Izveštaja o ispitivanju, shodno standardu 17025:2017 (tačke 7.8.3. i 7.8.6.)

Izjava o usaglašenosti

Izjava o usaglašenosti se daje u okviru Izveštaja o ispitivanju.

Korisnik usluga može zahtevati da se izvrše ispitivanja bez davanja izjave o usaglašenosti.

Izjava o usaglašenosti se daje na osnovu vrednosti parametara definisanih odgovarajućim pravilnikom ili deklaracijom, a u skladu sa dokumentovanim pravilima odlučivanja. Ako po pravilniku postoji više mogućih kombinacija kvaliteta proizvoda, a korisnik usluga je u svojoj deklaraciji definisao kombinaciju, onda se izjava o usaglašenosti daje prema deklaraciji (npr. polumasni meki sir ili polumasni polutvrđi sir, i sl.). Izjava o usaglašenosti prema deklaraciji daje se i u slučaju da je proizvod proizveden po specifičnim zahtevima.

Pravila odlučivanja pri iskazivanju usaglašenosti

A) Navođenje Izjave o usaglašenosti sa pravilnikom ili deklaracijom za jednu veličinu


Kad se rezultat merenja, koji uključuje proširenu mernu nesigurnost, poredi sa vrednostima definisanim u pravilniku ili deklaraciji (donjom ili gornjom granicom), mogu se razlikovati 4 slučaja (Slika 1):

1. slučaj: rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se ispod gornje granice, odnosno iznad donje granice definisane pravilnikom ili deklaracijom;

2. slučaj: rezultat merenja nalazi se ispod gornje granice, odnosno iznad donje granice definisane pravilnikom ili deklaracijom, ali interval proširene merne nesigurnosti prelazi granicu definisanu pravilnikom ili deklaracijom;

3. slučaj: rezultat merenja nalazi se iznad gornje granice, odnosno ispod donje granice definisane pravilnikom ili deklaracijom, ali interval proširene merne nesigurnosti obuhvata deo intervala definisan pravilnikom ili deklaracijom;

4. slučaj: rezultat merenja s proširenom mernom nesigurnošću nalazi se iznad gornje granice, odnosno ispod donje granice specifikacije.

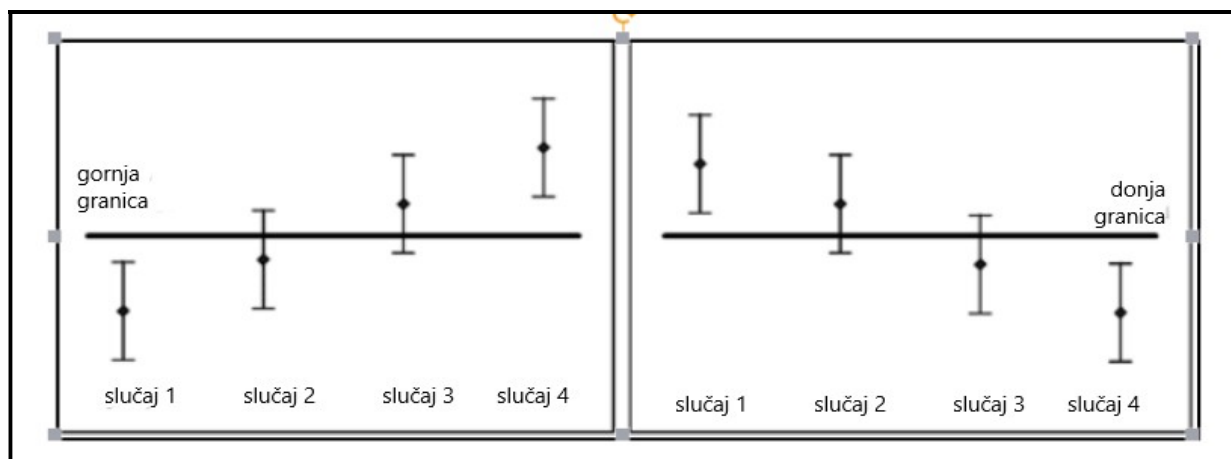

Slika 1. Usaglašenost sa graničnim vrednostima (gornja i donja granicu)

U 1. slučaju može se jasno dati izjava o usaglašenosti sa pravilnikom ili deklaracijom koja glasi:
-Rezultat merenja ODGOVORA/ZADOVOLJAVA pravilniku ili deklaraciji (sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost).

U 4. slučaju može se jasno dati izjava o neusaglašenosti sa pravilnikom ili deklaracijom koja glasi:
-Rezultat merenja NE ODGOVORA/NE ZADOVOLJAVA pravilniku ili deklaraciji (sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost).

U 2. i 3. slučaju ne može se dokazati ni usaglašenost niti neusaglašenost. Zato u takvom slučaju naša laboratorija korisnicima usluga pruža dve mogućnosti.

Prva mogućnost je da Izveštaj o ispitivanju (i za slučaj 2. i za slučaj 3. na slici 1.) ne sadrži ocenu o usaglašenosti.

Druga mogućnost je da Izveštaj o ispitivanju sadrži ocenu o usaglašenosti koja za slučaj 2. (na slici 1.) glasi: „Rezultat merenja ODGOVARA/ZADOVOLJAVA pravilniku ili deklaraciji” – uz napomenu da se “usaglašenost ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, što znači da postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe i izvan (iznad gornje ili ispod donje) granice specifikacije”.

Ako Izveštaj o ispitivanju sadrži ocenu o usaglašenosti za slučaj 3. (na slici 1.) ona glasi: „Rezultat merenja NE ODGOVARA/NE ZADOVOLJAVA pravilniku ili deklaraciji” – uz napomenu da se “neusaglašenost ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95% za proširenu mernu nesigurnost, što znači da postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe unutar (ispod gornje ili iznad donje) granice specifikacije”.

Ako se dobije rezultat merenja, koji je jednak granici specifikacije, tada se postupa kao za slučaj 3.

B) Navođenje Izjave o usaglašenosti sa pravilnikom ili deklaracijom za više veličina

Ako vrednovanje usaglašenosti sa specifikacijom obuhvata više merenih veličina, svaka merena veličina treba da se vrednuje nezavisno jedna od druge na način koji je prethodno opisan. Rezultat koji nije usaglašen sa vrednošću iz pravilnika ili deklaracije u izveštaju o ispitivanju prikazuje se boldirano.

Celokupno vrednovanje usaglašenosti se iskazuje na jedan od sledećih načina:

-Rezultati ispitivanih parametara ODGOVARAJU/ZADOVOLJAVAJU Pravilniku ili deklaraciji (ako su svi ispitivni parametri usaglašeni), ili

-Rezultati ispitivanih parametara NE ODGOVARAJU/NE ZADOVOLJAVAJU Pravilniku ili deklaraciji (ako bar jedan parametar nije usaglašen sa pravilnikom ili deklaracijom, a koji je na izveštaju o ispitivanju jasno označen podebljanim fontom - boldiran).

-Korisnik usluga se upozna sa pravilima odlučivanja pri potpisivanju ugovora.